

IHR - labPraksisnytt

INFORMASJON KOMMUNIKASJON SAMARBEID PRAKSISKONSULENTORDNINGEN


IHR: nye analysepakker for luftveisagens og tarmpatogene agens

Både luftveisagens og tarmpatogene agens har fått nye analysepakker som skal gjøre det enklere å rekvirere riktige analyser. Disse analysepakkene er tilpasset laboratoriets rutiner, slik at man unngår manuell justering ved mottak av prøvene.

Ved å holde musepekeren over analyse-navnet, vil det vises hvilke agens som inngår i pakken.


- **Influenza og andre luftveisagens**

«Hoste...» vil utgå som analyse. Søk i analysefelt på «Luft....» og velg den luftveipakken som ønskes.

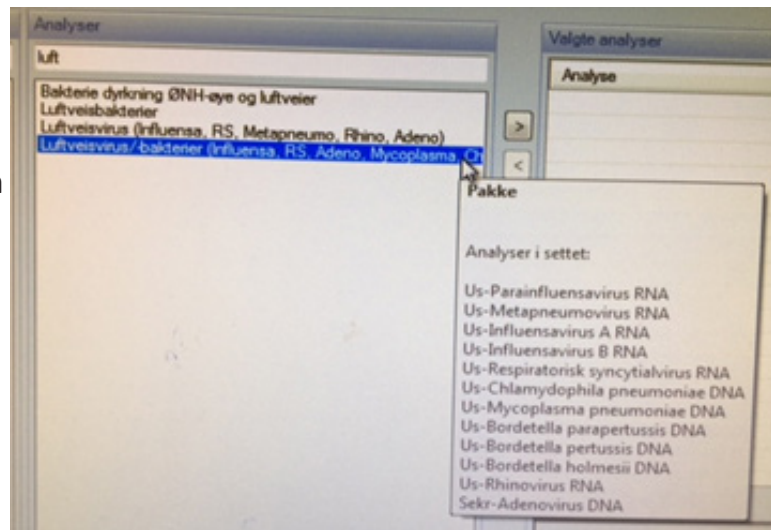

- **Tarmpatogene agens**

Søk i analysefelt på «Tarm....» og velg det alternativet som ønskes:

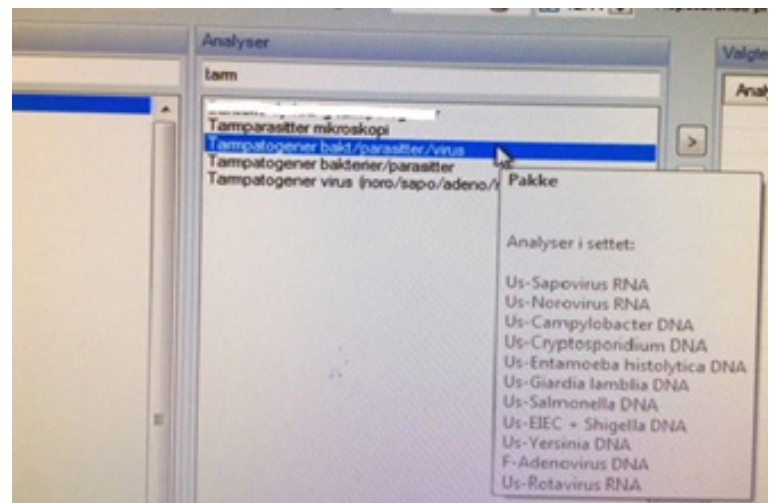


HR: CITO-prøver histologi

For å sikre at prøven behandles som hasteprobe allerede ved mottak på patologiavdelingen, må det stå CITO på prøveglassets etikett. Dette skrives automatisk på etiketten når det er haket av for «Ø-hj» ved rekvirering. Alternativt må CITO skrives for hånd på etiketten. Hvis hastegrad kun beskrives i kliniske

opplysninger, vil det dessverre kunne gå mange dager før dette oppdages.

HIST ØHJELP



CITO ETIKETT



Riktig valg av 4 mL og 6 mL EDTA-rør

- 6 mL EDTA-rør benyttes kun til svangerskapsundersøkelser, men ikke til hematologi eller HbA1c.
- 4 mL EDTA rør må benyttes til hematologi og HbA1c. 6mL rør passer ikke i analyseinstrumentene og dette gir merarbeid og forsinkelser ved mottak.

Det skal være angitt på etikettutskriften fra IHR om det skal benyttes 4 mL eller 6 mL EDTA-rør.

Se bilde av EDTA-rør



Spørsmål om IHR kan rettes til

Toril Holmøy Svendsen

Laboratorierådgiver for primærhelsetjenesten

Telefon 90 96 36 69

E-post: brukerkontakt.lab@siv.no